

## Alarm Status

>27,0 °C	✓	OK
>10,0 °C	✗	Fail
<2,0 °C	✗	Fail
<-10,0 °C	✗	Fail

## Indicator Info

<b>Serial # :</b> 2090010082	<b>Model :</b> TICT	<b>Batería :</b> Ok
<b>ID Usuario :</b>		
<b>Interval :</b> 5 Minutos		
<b>Start delay :</b> 20 Minutos		

## Alarm Configuration

<b>Alerta mayor (HT1) &gt;10,0 °C :</b> Acumuladas 1 Hora	<b>Alerta menor (LT1) &lt;2,0 °C :</b> Consecutives 50 Minutos
<b>Alerta mayor (HT2) &gt;27,0 °C :</b> Instant	<b>Alerta menor (LT2) &lt;-10,0 °C :</b> Instant

## Recorded Data

<b>Intervalo :</b> 45 Días	<b>Temperature statistics</b> <b>Lowest :</b> -17,0 °C on day 8 <b>Highest :</b> 26,5 °C on day 37
----------------------------	--

### Alerta mayor (HT1) >10,0 °C

<b>Triggered :</b> 55 Minutos
<b>Time above :</b> 2 Días, 7 Horas, 5 Minutos

### Alerta menor (LT1) <2,0 °C


<b>Triggered :</b> 2 Días, 1 Hora, 5 Minutos
<b>Time below :</b> 34 Días, 18 Horas

### Alerta mayor (HT2) >27,0 °C

<b>Triggered :</b> (none)
<b>Time above :</b> (none)

### Alerta menor (LT2) <-10,0 °C

<b>Triggered :</b> 2 Días, 25 Minutos
<b>Time below :</b> 34 Días, 17 Horas, 55 Minutos

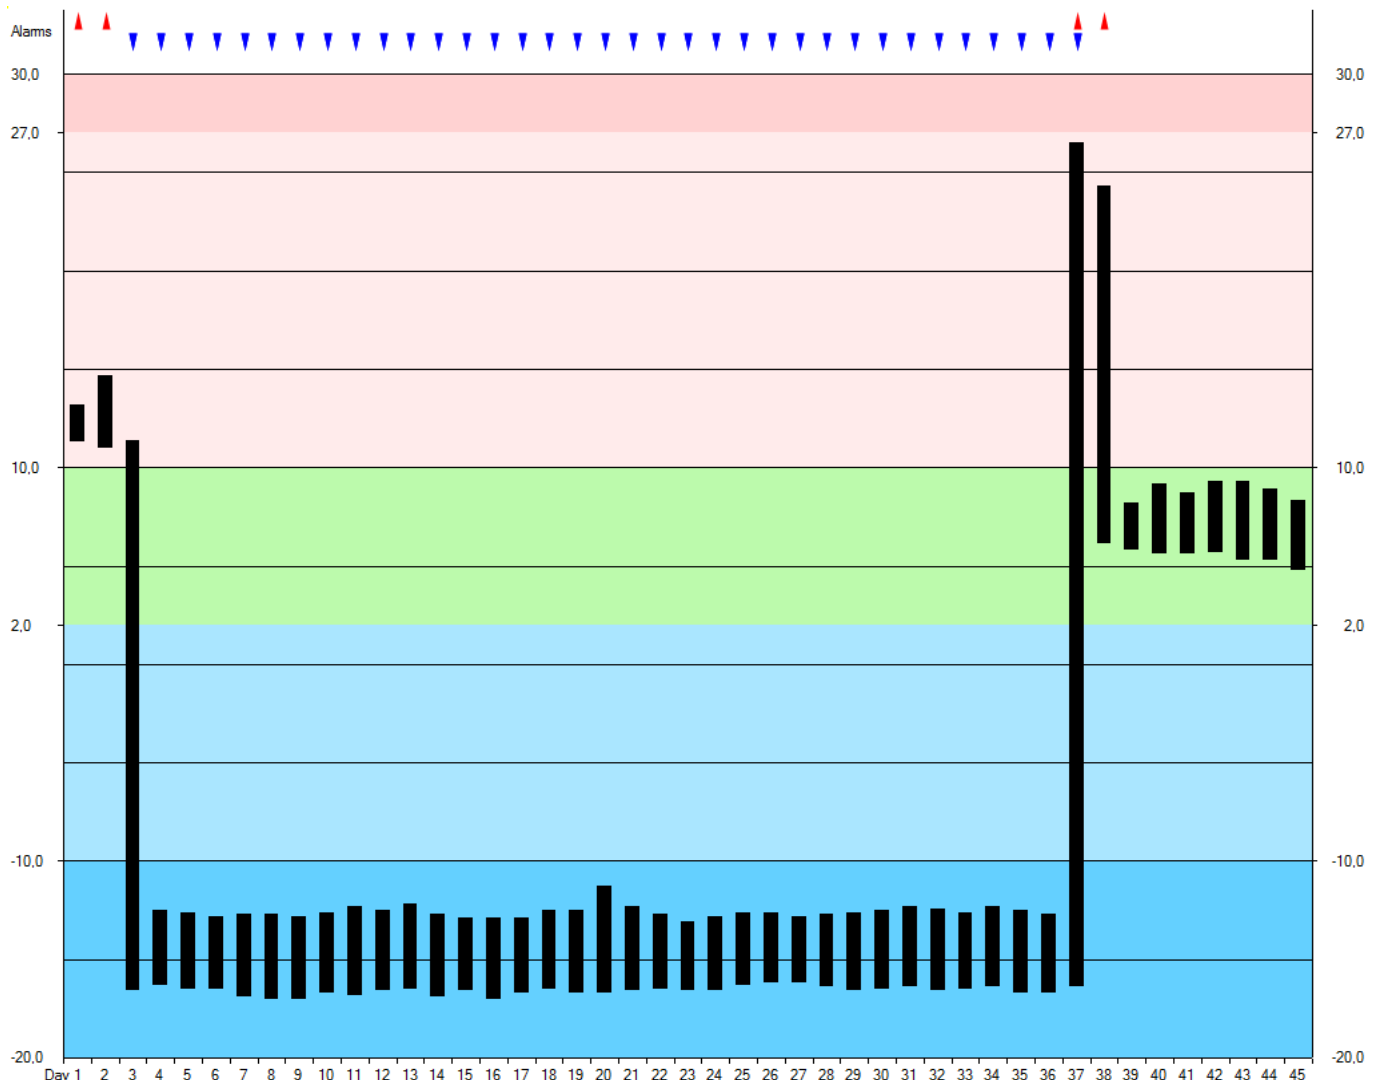

# Resumen Diario

Nombre del archivo: D:\AKRIBIS\2090010082 Downloaded 27-06-2014 9\_27\_20.ltd

ID LogTag: 003F4D0D22

	Lectura Mx. (°C)	Lectura Mn. (°C)	LT2: < -10,0°C Time below :	Triggered	LT1: < 2,0°C Time below :	Triggered	HT1: > 10,0°C Time above :	Triggered	HT2: > 27,0°C Time above :	Triggered
1	13,2	11,3					1 Da	55 Minutos		
2	14,7	11,0					1 Da	55 Minutos		
3	11,4	-16,6	23 Horas, 35 Minutos	25 Minutos	23 Horas, 40 Minutos	1 Hora, 5 Minutos	20 Minutos			
4	-12,5	-16,3	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	25 Minutos			
5	-12,6	-16,5	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	35 Minutos			
6	-12,8	-16,5	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	45 Minutos			
7	-12,7	-16,9	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	5 Minutos			
8	-12,7	-17,0	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	15 Minutos			
9	-12,8	-17,0	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	25 Minutos			
10	-12,6	-16,7	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	35 Minutos			
11	-12,3	-16,8	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	45 Minutos			
12	-12,5	-16,6	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	5 Minutos			
13	-12,2	-16,5	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	15 Minutos			
14	-12,7	-16,9	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	25 Minutos			
15	-12,9	-16,6	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	35 Minutos			
16	-12,9	-17,0	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	45 Minutos			
17	-12,9	-16,7	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	5 Minutos			
18	-12,5	-16,5	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	15 Minutos			
19	-12,5	-16,7	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	25 Minutos			
20	-11,3	-16,7	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	35 Minutos			
21	-12,3	-16,6	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	45 Minutos			
22	-12,7	-16,5	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	5 Minutos			
23	-13,1	-16,6	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	15 Minutos			
24	-12,8	-16,6	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	25 Minutos			
25	-12,6	-16,3	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	35 Minutos			
26	-12,6	-16,2	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	45 Minutos			
27	-12,8	-16,2	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	5 Minutos			
28	-12,7	-16,4	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	15 Minutos			
29	-12,6	-16,6	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	25 Minutos			
30	-12,5	-16,5	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	35 Minutos			
31	-12,3	-16,4	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	45 Minutos			
32	-12,4	-16,6	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	5 Minutos			
33	-12,6	-16,5	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	15 Minutos			
34	-12,3	-16,4	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	25 Minutos			
35	-12,5	-16,7	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	35 Minutos			
36	-12,7	-16,7	1 Da	0 Minutos	1 Da	1 Da	45 Minutos			
37	26,5	-16,4	18 Horas, 20 Minutos	0 Minutos	18 Horas, 20 Minutos	5 Minutos	5 Horas, 40 Minutos	18 Horas, 55 Minutos		
38	24,3	6,1					1 Hora, 5 Minutos	16 Horas		
39	8,2	5,8								
40	9,2	5,6								
41	8,7	5,6								
42	9,3	5,7								
43	9,3	5,3								
44	8,9	5,3								
45	8,3	4,8								

Intervalo 45 Das